

例如：将病房门口机设置成10号NNV主机下的20号病房门口机，依次输入以下信息：

“本机编号”：NNV-120、010、020 (主机型号为NNV主机，设备编号不可重复)；

“地址盒IP”：192.168.1.169 (需和主机输入同一个IP地址)；

“本病房号”：1002 (可以自定义房号)；

“IP地址”：192.168.1.22，“子网掩码”：255.255.255.0，“网关”：192.168.1.1；

“信息发布服务器”：192.168.1.111；

最后点“保存”按钮，设备将重新启动。设置完成，设备可正常呼叫对讲。

按以上步骤，给设备接入网络并设置好。

3、**声音亮度设置**：可点击拖动进度条设置系统音量、媒体音量、通话音量及屏幕亮度。

4、**分机编码**：如果门口机需要管理数字病床分机，需要将该数字病床分机由“未分配分机”列表移至“本机分机”列表，点击保存按钮，即可将已添加的病床分机号归到本病房门口机下管理。依此方法，进入每个病房门口机的分机设置页面中，选中需要添加管理的网络病床分机号。

5、**其它设置**：可设置医生护士照片和呼叫按钮为门口机的主界面，最后点击保存即可（界面设置）。

6、**配置管理**：可进行恢复出厂设置。

7、**系统重启**：对设备进行重启。

三、使用说明：

1、在护士站主机上输入分机床位信息、责任护士和医生信息：

(1) 输入分机床位信息：在主机主界面上，按住对应的分机键3秒，即可在弹出的分机信息框中输入或修改。

(2) 输入责任护士、责任医生的姓名：在主机主界面左边，选择“呼叫门口机”键；再按住某个路选门口机键3秒，会弹出对话框，可手动选择某科室下的护士、医生的姓名。保存后，系统会自动从HIS交互服务器上获取医生和护士的照片到病房门口机上(注：也可在此点击分机按键，输入分机床位信息，方法相同)。

2、护士、医生照片的上传：在电脑型地址盒的“系统设置”--“照片管理”中“医生、护士照片管理”：

将在列表中为某个医生(或护士)增加相片。点击某个医生后面的操作按钮，可在对话框中点击“浏览”按钮，在电脑中选择一张照片打开，最后点击“保存”。

3、**显示本病房内分机呼叫信息**：分机呼叫时，病房门口机上该路分机按键显示红色常亮，伴有语音播报“XX号分机呼叫”及音乐提示声，同时该病房门外的门灯亮。

注：病房门口机不可接听病床分机呼叫，只便于走廊中的护士查看；如护士站主机接听了该路分机呼叫时，病房门口机上该路分机按键显示绿色常亮。

4、呼叫主机（注：病房门口机呼叫主机时门灯闪亮红色，接听通话后门灯变为红色常亮）：

(1) 呼叫解除：点击“呼叫解除”按键可结束本房间内的分机呼叫。

注：报警类信息仍需到报警设备端解除。

(2) 护士站主机：点击病房门口机上的“呼叫护士站”键，即进入呼叫状态，待护士站主机接通，可双向可视对讲。

5、**护理定位功能**：护士按下病房门口机上的“进入护理”按键，按键变为绿色显示“护理中”，该病房门口门灯常亮青色，走廊显示屏显示“XXXX房门口机护理中”，离开时可再次按下此键解除该功能。

IP门口机

产品安装使用说明






一、安装调试:

1、产品安装图:



2、背面接口说明:

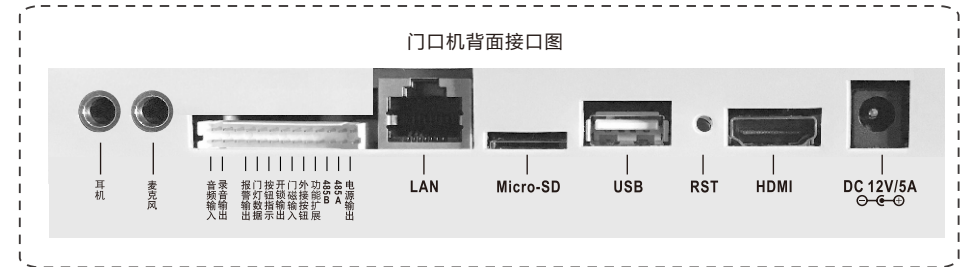

(1) **网络接口:** 通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上(需和所属主机在同-局域网内)。

注: 配送三通方便网线对接。

(2) **电源插头:** 将自带的(12V/5A)电源的输出插头接到此处, 给设备供电。

(3) **复位键(RST):** 长按“RST”键约5-6秒, 可自动恢复出厂设置。

(4) **HDMI接口:** (暂未启用) HDMI视频输出, 可外接显示屏。

(5) **USB接口:** 通用USB接口, 可外接鼠标等。

(6) **Micro-SD:** 可插入最大32G的Micro-SD作为存储数据之用。

(7) **外部设备接口:**

① 接门灯(NBW-ME): 将门口机的电源输出(绿)、门灯数据(黄)、地线(黑)三芯引线对应与门灯上黄红黑三芯引线相连。

② 接门灯(NBW-ME5): 将门口机的电源输出(绿)、门灯数据(黄)、地线(黑)三芯引线对应与门灯上红白黑三芯引线相连。

③ 接ANW3: 将门口机的外接按钮(棕)、地线(需)两芯引线对应与ANW3的两芯线相连(不分极性)。

④ 接ANW4: 将门口机的报警输出(花黑)、外接按钮(棕)地线(黑)三芯线对应与ANW4的红白黑三芯引线相连。

注: 其它接口暂无需使用。

外部设备接口功能与颜色对照表									
音频输入	录音输出	报警输出	门灯数据	按钮指示	开锁输出	门磁输入	外接按钮	门磁输入	电源输出
红黑	粉黑	花黑	黄黑	蓝黑	黄绿、黑	橙黑	棕黑	白黑	绿黑

二、设置调试:

注: 登录该设备的网页(即该设备的IP地址, 账号密码默认为admin)进入设置界面。

1、**系统信息:** 可查看分机的详细信息(包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、IP地址等信息)。

2、**基本设置(必填):**

注: 由于设备出厂时默认使用的IP地址相同, 初次安装时, 请不要同时接入多台没有修改IP的设备到网络中, 以免网冲突。

将B22C病房门口机插上网络并通电, 设备启动中会显示IP(默认为192.168.1.168), 待设备启动完毕后, 登录该设备的网页(即该设备的IP地址, 账号密码默认为admin)进入“基本设置(必填)”界面。

设置方法如下: